



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0984

检测报告

No: WJ2024041002

样品名称: 无油涡旋真空泵

委托单位: 沈阳纪维应用技术有限公司

检测类别: 委托检测



沈阳汇真真空技术有限公司
国家真空设备质量检验检测中心

注 意 事 项

- 1、一般情况，委托检测仅对收到样品检测的数据和结果负责；
- 2、检测报告无“检验检测专用章”无效；
- 3、检测报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测报告涂改无效；
- 5、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；
- 6、当出现偏离检测方法或无标准时，按委托方要求，由本公司制定检测细则，严格按照检测细则检测，并出具检测报告；
- 7、委托方如对检测报告内容及结果有异议，请于领取检测报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。

名 称：沈阳汇真真空技术有限公司
(国家真空设备质量检验检测中心)
地 址：辽宁省沈阳市大东区万柳塘路 2 号
电 话：024-24807944 024-24819625
传 真：024-24807944
邮政编码：110042
邮 箱：hui zhenzk@126. com
网 址：www. syhzzk. com

沈阳汇真真空技术有限公司
国家真空设备质量检验检测中心

检测报告

No: WJ2024041002

共4页 第1页

样品描述及识别	样品名称	无油涡旋真空泵		
	规格型号	GWSP150	商标	/
	检测地点	沈阳汇真真空技术有限公司 检验检测室		
	生产单位及地址	沈阳纪维应用技术有限公司 沈阳市浑南区创新一路 99 甲-18 号(110169)		
	委托单位及地址	沈阳纪维应用技术有限公司 沈阳市浑南区创新一路 99 甲-18 号(110169)		
	样品接收日期	2024 年 04 月 10 日	送样人	宁宪宁
	样品状态	完好	样品编号	C20240410-02-01
样品特征和状态	样品等级	/	样品原编号	20818F
	样品数量	1 台	外型尺寸 mm	455×260×296
	样品颜色	灰色	样品重量 kg	22
检测依据	GB/T40344.1-2021《真空技术 真空泵性能测量标准方法第1部分:总体要求》、 GB/T40344.2-2021《真空技术 真空泵性能测量标准方法第2部分:容积真空泵》、 JB/T11080-2011《真空技术 涡旋干式真空泵》			
检测项目	基础压力、体积流率(曲线)、最大消耗功率(曲线)			
检测结论	检测结果见数据页。  签发日期: 2024年 4 月 15 日			
备注				

批准:

审核:

主检:

沈阳汇真真空技术有限公司
国家真空设备质量检验检测中心

检测报告

No: WJ2024041002

共4页 第2页

序号	检测项目名称 (单位)	标准要求 或条款号	实测结果	本项 结论	备注
1	基础压力 (Pa)	/	2.3	/	以下空白
2	体积流率 (L/s)	/	见曲线	/	
3	最大消耗功率 (W)	/	269.8	/	
		以下空白			
检测 环境 条件	环境温度: 19.6℃ 相对湿度: 39.5% 大气压力: 1009.0hPa				
检测 主要 设备	J019-1 [#] 、J019-2 [#] 、J019-3 [#] 电容薄膜真空计、 256 [#] 、257 [#] 、263 [#] 玻璃转子流量计 033 [#] 玻璃滴管流量计、167 电子秒表 244 [#] 、276 [#] 手持式数字温度计 260 [#] 功率分析仪 034 [#] 空盒气压表 288 [#] 温湿度记录仪				
检测 日期	2024 年 04 月 11 日				


沈阳汇真真空技术有限公司
国家真空设备质量检验检测中心

检测报告


No: WJ2024041002

共4页 第3页

入口压力、体积流率-曲线

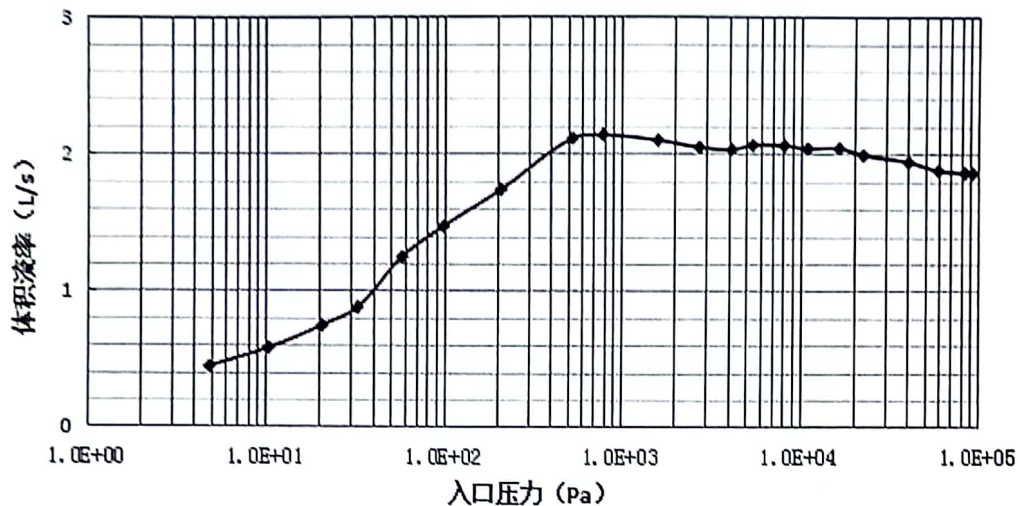

入口压力、消耗功率-曲线

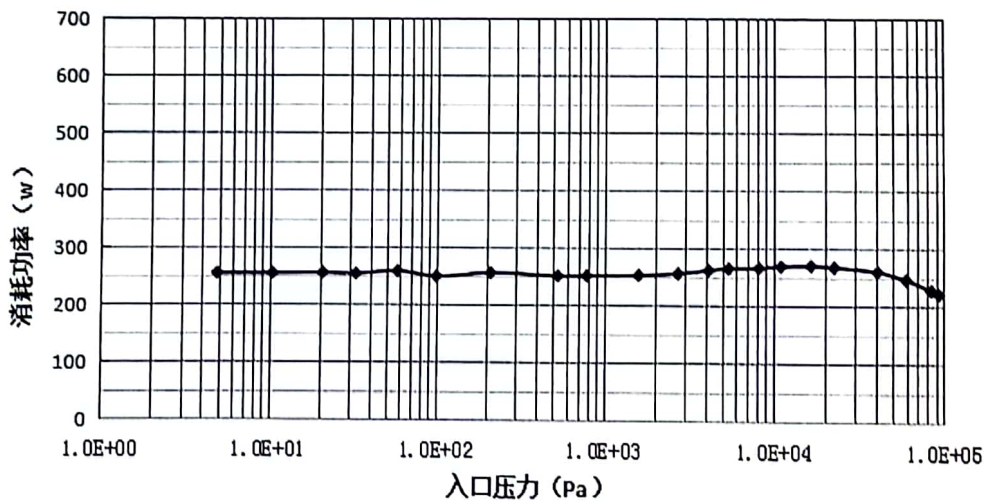

沈阳汇真真空技术有限公司
国家真空设备质量检验检测中心

检测报告

No: WJ2024041002

共4页 第4页

入口压力、体积流率和消耗功率-曲线表

入口压力 (Pa)	体积流率(L/s)	消耗功率 (w)	入口压力 (Pa)	体积流率(L/s)	消耗功率 (w)
4.89	0.44	254.42	4145.56	2.03	261.62
10.43	0.58	254.45	5443.06	2.06	264.87
20.68	0.74	255.24	8173.46	2.06	265.71
32.59	0.87	253.94	11009.20	2.04	268.79
58.07	1.25	258.47	16502.53	2.04	269.82
99.19	1.47	249.60	22545.19	1.99	267.33
209.71	1.74	255.98	40466.77	1.94	259.81
531.49	2.11	250.97	59713.99	1.88	245.97
788.50	2.14	251.48	84341.28	1.86	227.61
1605.53	2.10	252.69	93450.95	1.86	221.13
2742.55	2.05	255.76	/	/	/

